UNIVERSITÄTSmedizin. MAINZ

Institut für Klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin
Direktor: Univ.-Prof. Dr. K.J. Lackner

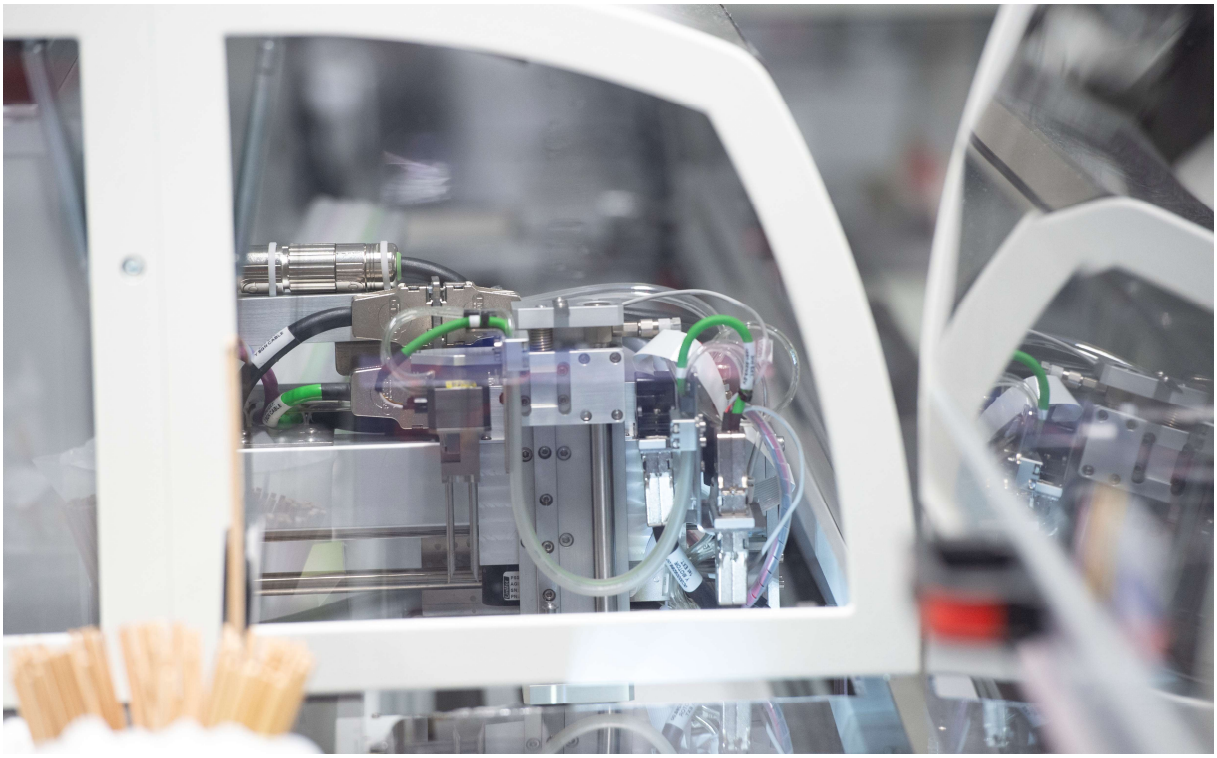

! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors!

Veränderte Wertelage bei der Bilirubin-Bestimmung

Die Bilirubin-Bestimmung bezieht sich auf einen neuen Kalibrations-Standard (NIST 916b), da der bisher verwendete Standard (NIST 916a) nicht mehr verfügbar ist.

Daraus resultiert eine veränderte Wertelage, die exakt 10% niedriger als die bisherige ist.

Zeitpunkt der Umstellung: 08-05-2024

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.

08-05-2024

M. Lotz

Lotz