


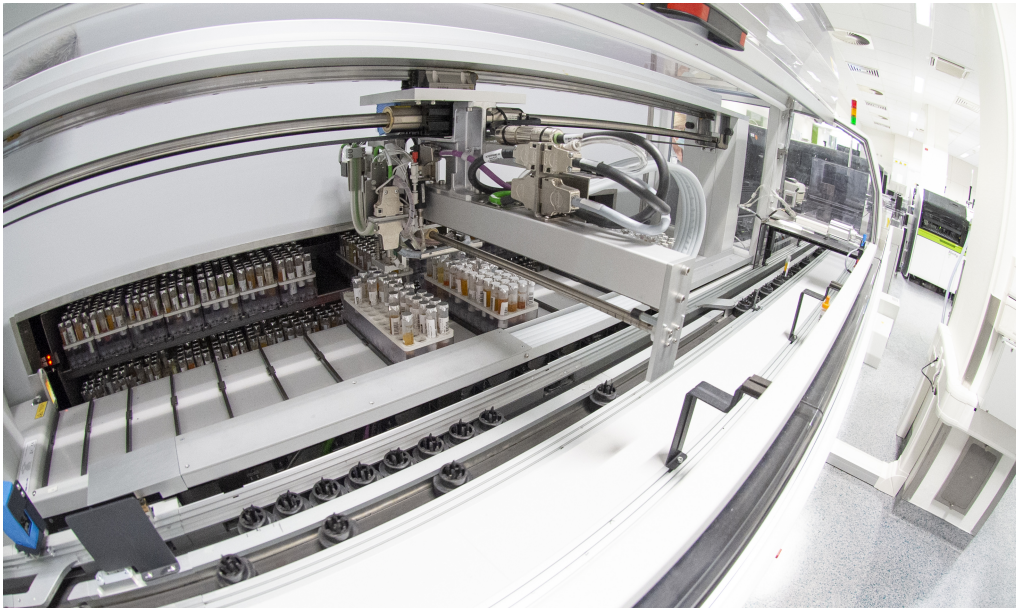

! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors !

Änderung der Methode und des cut-off zur Bestimmung des TSH-Rezeptor-Autoantikörper (TRAK)

Die Testumstellung erfolgt am Donnerstag, dem 01.12.2021

Aufgrund einer notwendigen laborinternen Umstrukturierung wurde ein neuer TRAK-Assay etabliert. Der Nachweis von TSH-Autoantikörpern basiert - wie auch bisher - auf der Verwendung humaner TSH-Rezeptoren. Dieser neue TRAK-Assay der 3. Generation zeigt eine etwas höhere Wertelage sowie eine verbesserte Sensitivität. Der neue TRAK-Assay weist eine gute Korrelation zum bisher verwendeten Test auf ($r=0,94$).

Bedingt durch die veränderte Wertelage wurde der cut-off angepasst:

TRAK: < 2,6 IU/l

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.

01.12.2021

Lotz