UNIVERSITÄTSmedizin. MAINZ

Institut für Klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin
Direktor: Univ.-Prof. Dr. K.J. Lackner

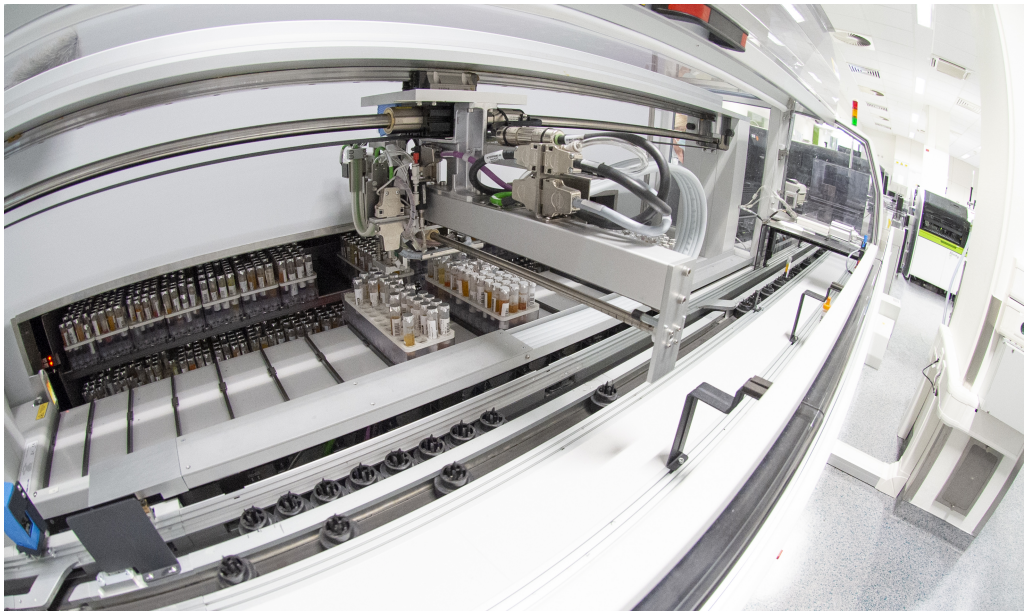

! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors !

Neuer Assay zur Bestimmung des humanen Thyreoglobulin im Serum (hTG)

Aufgrund einer notwendigen laborinternen Umstrukturierung wird ein neuer Thyreoglobulin-Assay etabliert. Der neue Assay ist, wie auch der bisherige, auf den CRM-457 Standard kalibriert. Die Übereinstimmung der Messergebnisse beider Assays ist sehr gut.

Regressionsgleichung für Konzentrationen < 50 µg/l: hTG-neuer Assay = 0,99*hTG alter Assay + 0,05.

Die Testeinführung erfolgt am 10.02.2022

neuer Referenzbereich: 3,7 - 64,0 µg/l, (alter Referenzbereich: 3,5 – 77 µg/l)
Limit of Detection (LoD): 0,05 µg/l

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.

01.02.2022

Lotz