JG|U UNIVERSITÄTSmedizin. MAINZ

Institut für Klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin
Direktor: Univ.-Prof. Dr. K.J. Lackner

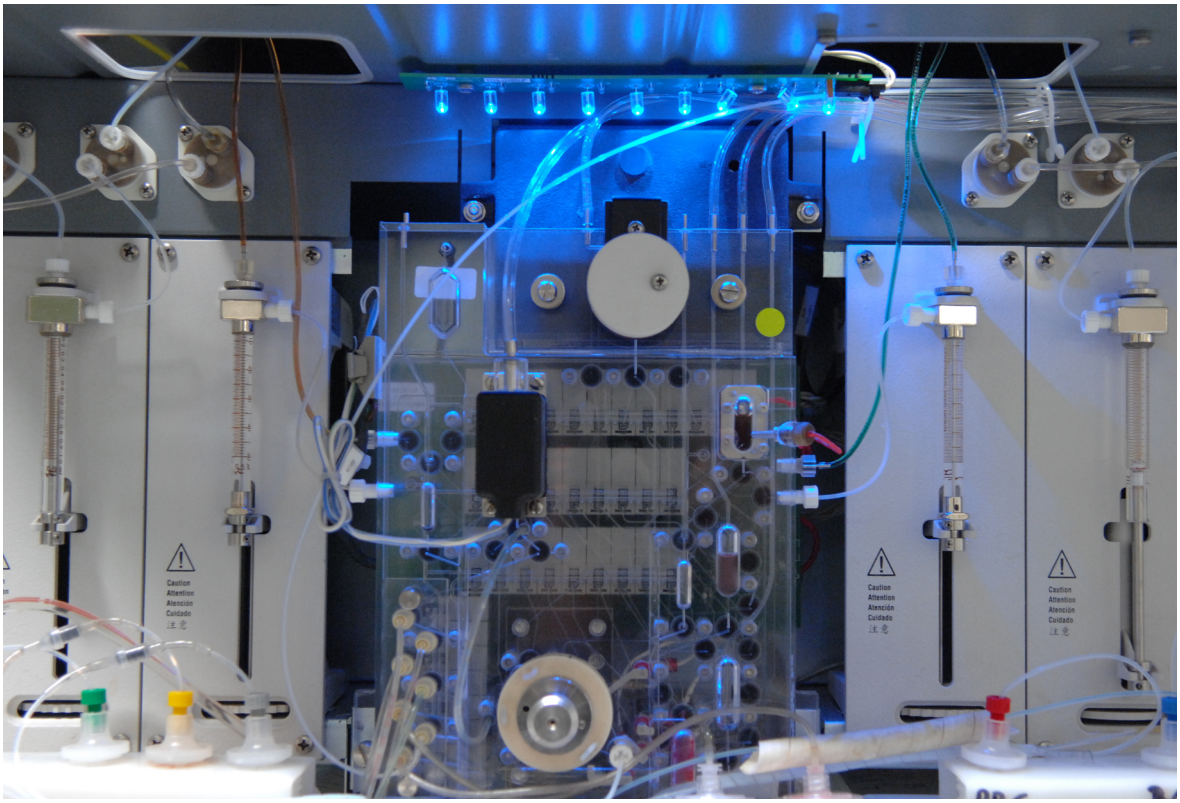

! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors !

Umstellung einiger Assays in der klinischen Chemie

Im Rahmen der Produktpflege und –verbesserung durch den Reagenzhersteller werden neue Reagenzien für vorerst drei Parameter eingeführt. Die Werteübereinstimmung zwischen neuem und altem Assay ist sehr gut, so dass die Referenzbereiche nicht oder nur gering-gradig angepasst werden müssen.

Die Testeinführung erfolgt am 26-04-2022
Folgende Parameter sind betroffen:

- **Albumin:** **keine Änderung** **bei Pat. ≤ 60a**
  32-46 g/l **bei Pat. > 60a** **(bisher: 34-48 g/l)**
- **ges.-Eiw.:** **keine Änderung**
- **gamma-GT:** **m: < 55 U/l** **w: < 38 U/l** **(bisher: m <64, w < 36)**

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.

25-04-2022
M. Lotz
Lotz