


## WICHTIGE MITTEILUNG AUS DEM ZENTRALLABOR

### Änderungen bei der ADAMTS13 Hemmkörperbestimmung, sowie der ADAMTS13 Aktivitätsmessung

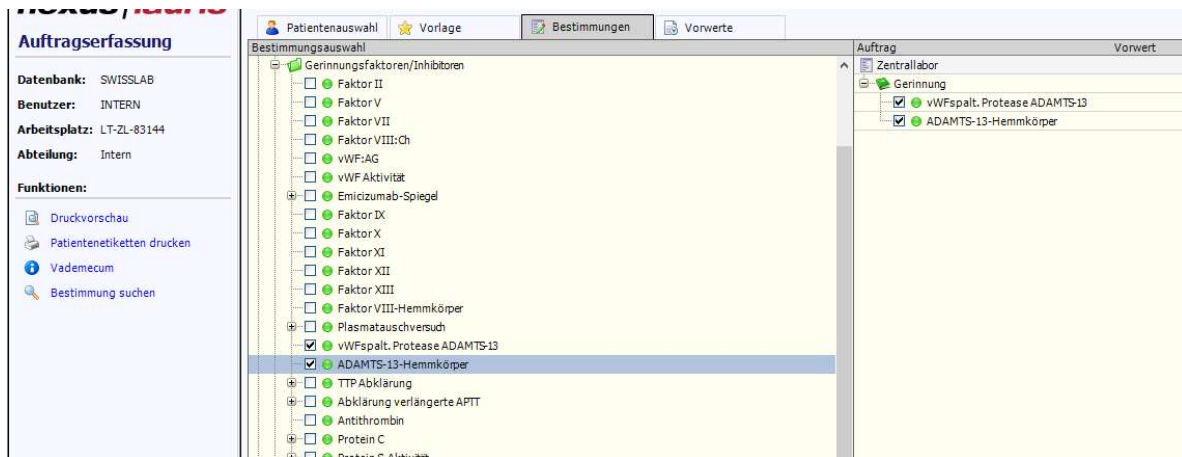

Ab sofort wird bei ADAMTS13 Aktivitäten von  $>20\%$  kein ADAMTS13 Hemmkörper mehr bestimmt.

Zudem wird bei Patienten mit einem Bilirubinspiegel von  $\geq 6,0$  mg/dl keine ADAMTS13 Aktivitätsmessung mittels FRETSS Assay mehr vorgenommen, da es bei hohen Bilirubinspiegeln zu falsch niedrigen ADAMTS13 Aktivitäten kommt.

Für Rückfragen steht der Diensthabende (Tel. -2121) zur Verfügung.

25.07.2022

Das Zentrallabor